



Désinfection des sondes d'échographie endovaginales : projet d'amélioration des pratiques par formation par simulation



Date: 02 juin 2022

Auteurs : Santa Soualah, Sabrina Dacquay ,Marie-Laure Eszto, Laurie Renaudin
Orateur : Sabrina Dacquay

Déclaration des liens d'intérêt

1. Aucun lien d'intérêt à déclarer

Contexte

1. SF2H → HCSP Risque infectieux autour des SEEV

HPV 80% poignées des sondes




2. Avril 2016 : HCSP → GREPHH enquête nationale autour de la désinfection des SEEV



HFME Metz 2018 : 7650 actes d'échographie endovaginale



Matériel et méthode

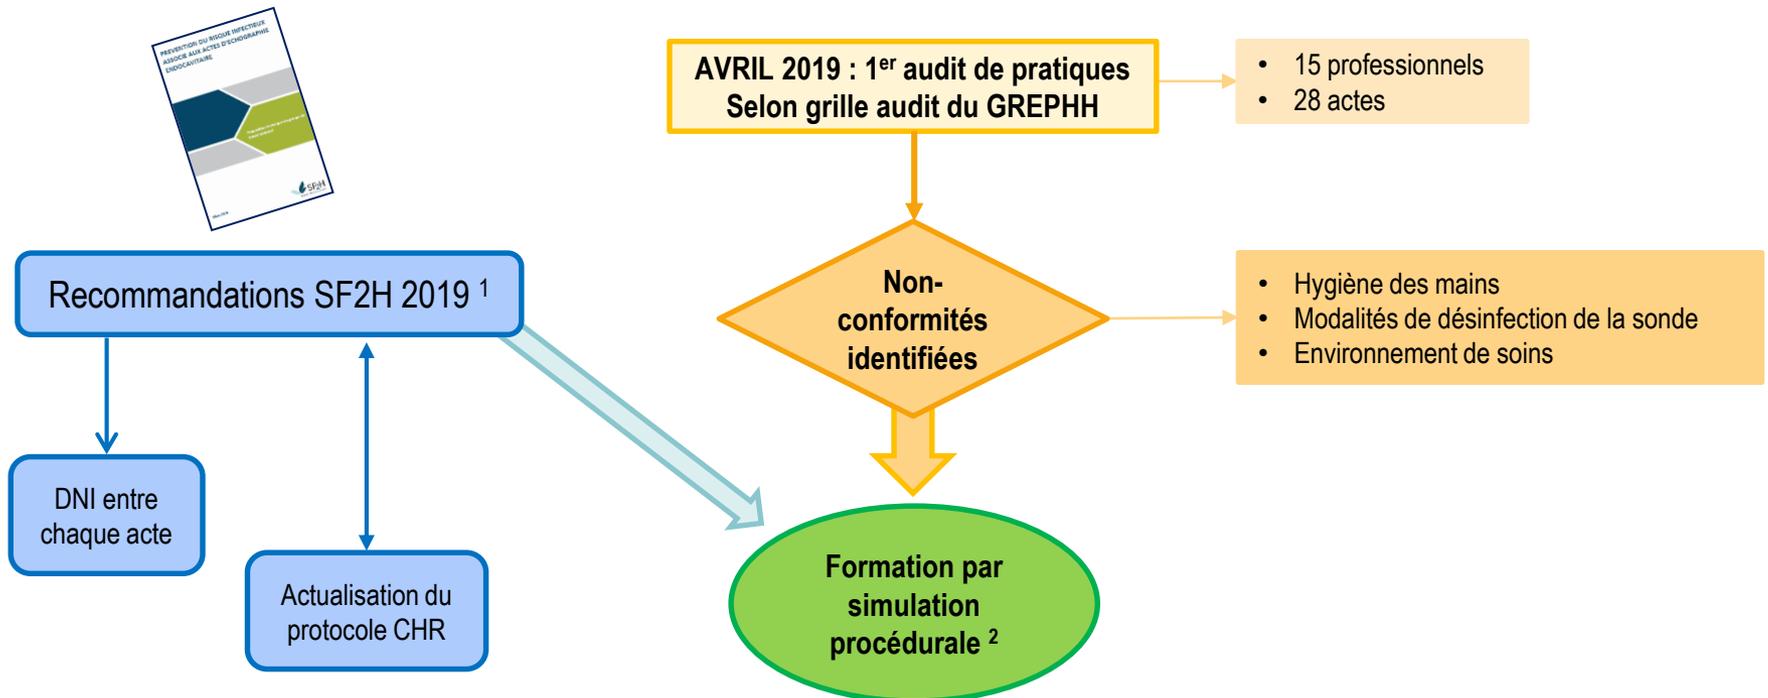

¹ SF2H. Prévention du risque infectieux associé aux actes d'échographie endocavitaire. Mars 2019

² HAS Guide des bonnes pratiques en matière de simulation en santé, Décembre 2012

Matériel et méthode

- Formation par simulation procédurale

- Proche du terrain
- Climat de confiance
- Questionnement des pratiques de soins entre pairs
- Amélioration des pratiques : risque infectieux
- Acquisition et réactualisation des connaissances théoriques et pratiques



Matériel et méthode

Objectif : former 100% du personnel audité
Groupe de 4 personnes/1h
8 créneaux

ECHOGRAPHIE
N°4



Briefing

- Présentation des résultats
- Présentation des recommandations SF2H
- MEP DNI en juillet 2019


Déroulement de la séquence

- Réalisation de l'acte par SHH
- Par les participants
- Discussion entre chaque acte

Débriefing


- Analyse points forts et faibles
- Attestation

Matériel et méthode

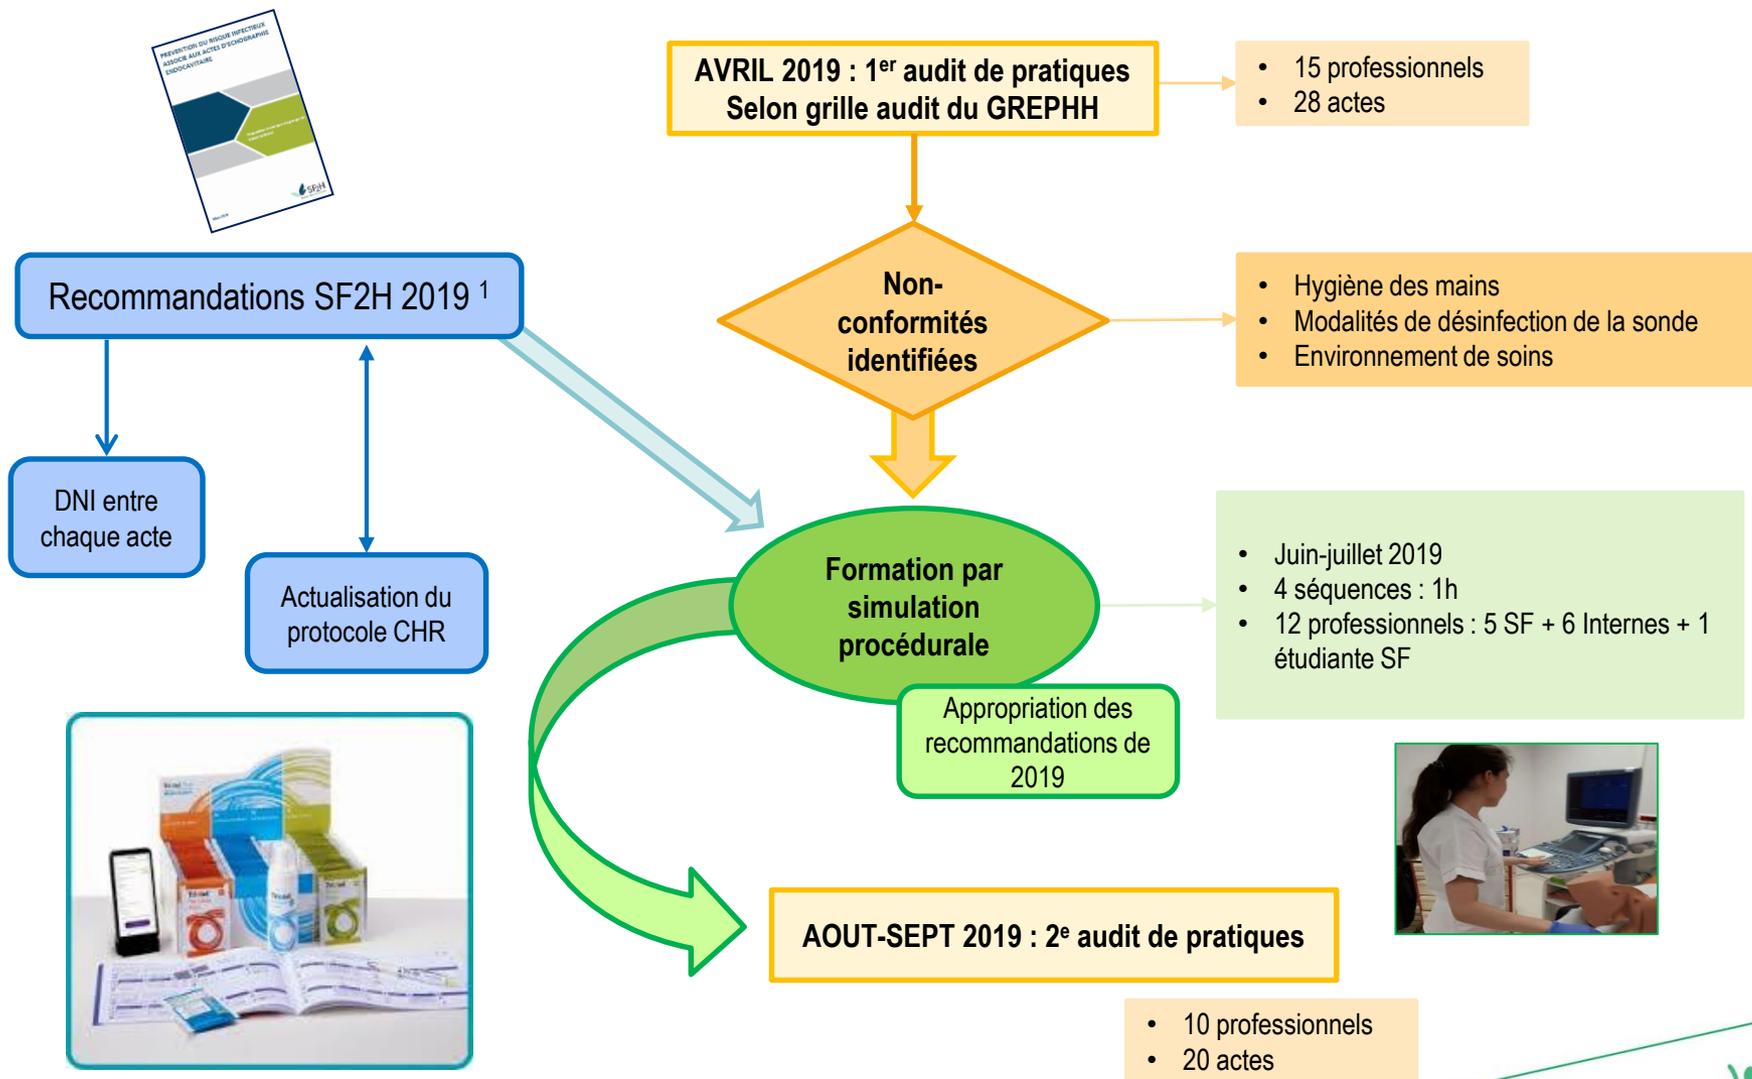


¹ SF2H. Prévention du risque infectieux associé aux actes d'échographie endocavitaire. Mars 2019

Résultats

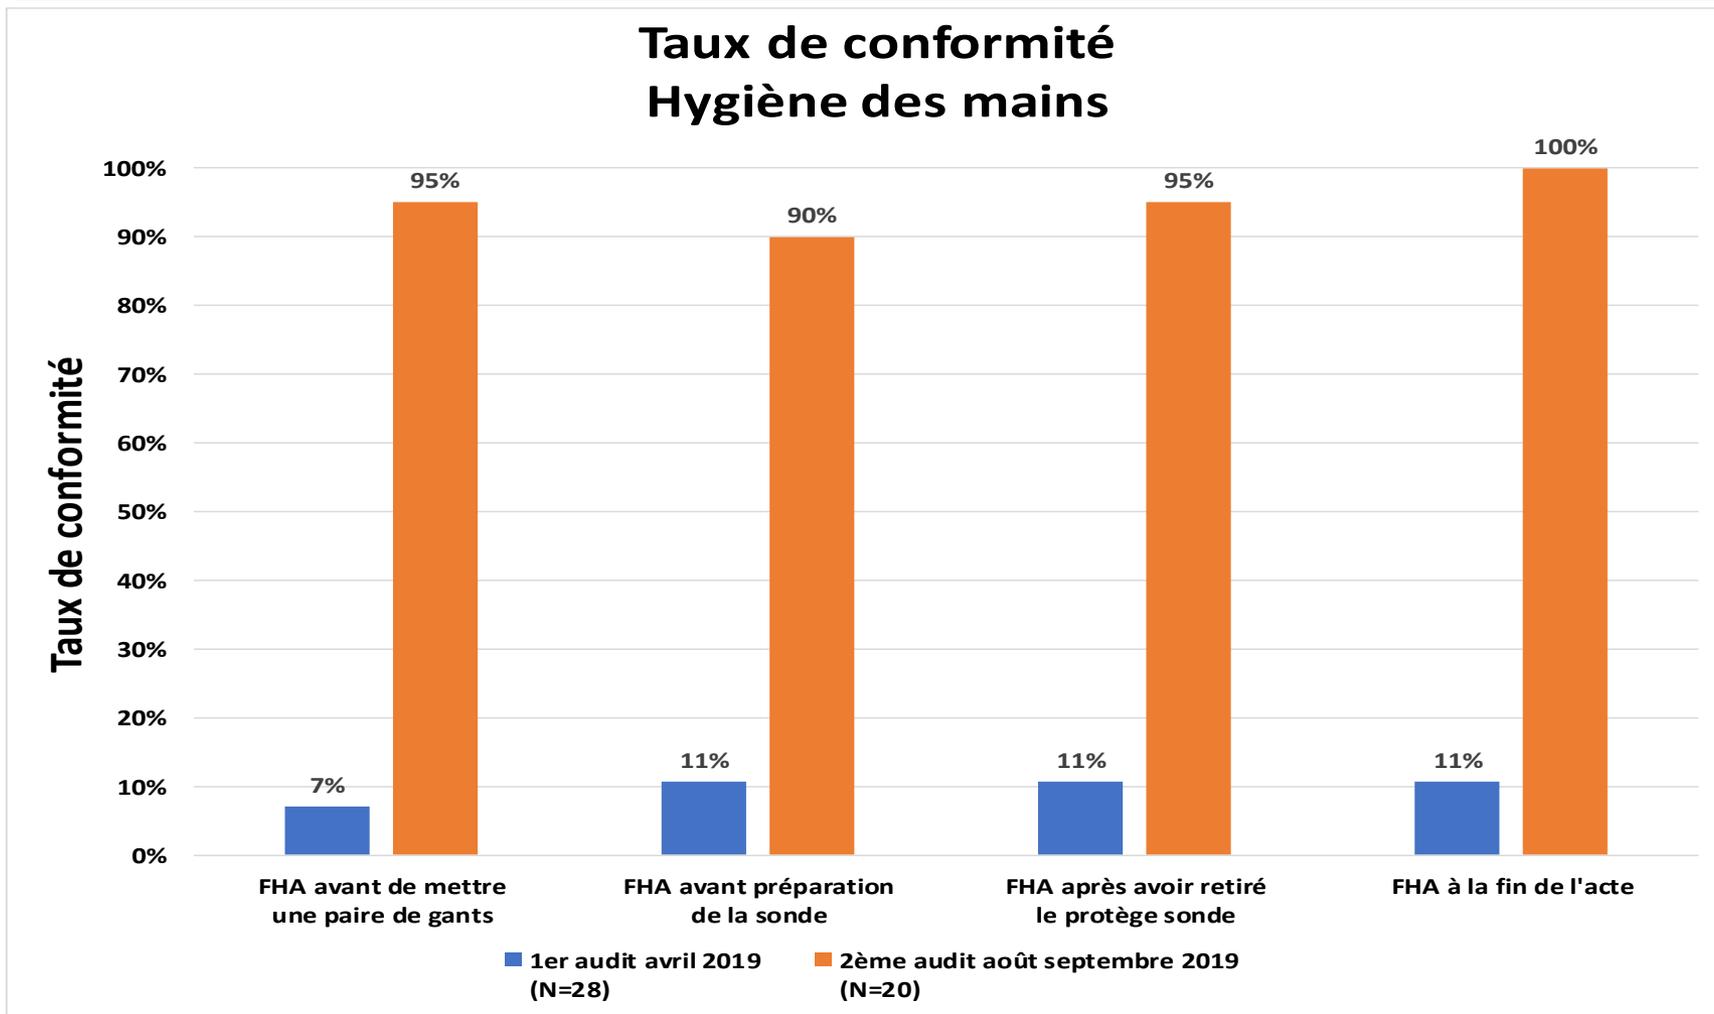

Amélioration des pratiques concernant l'hygiène des mains


Résultats

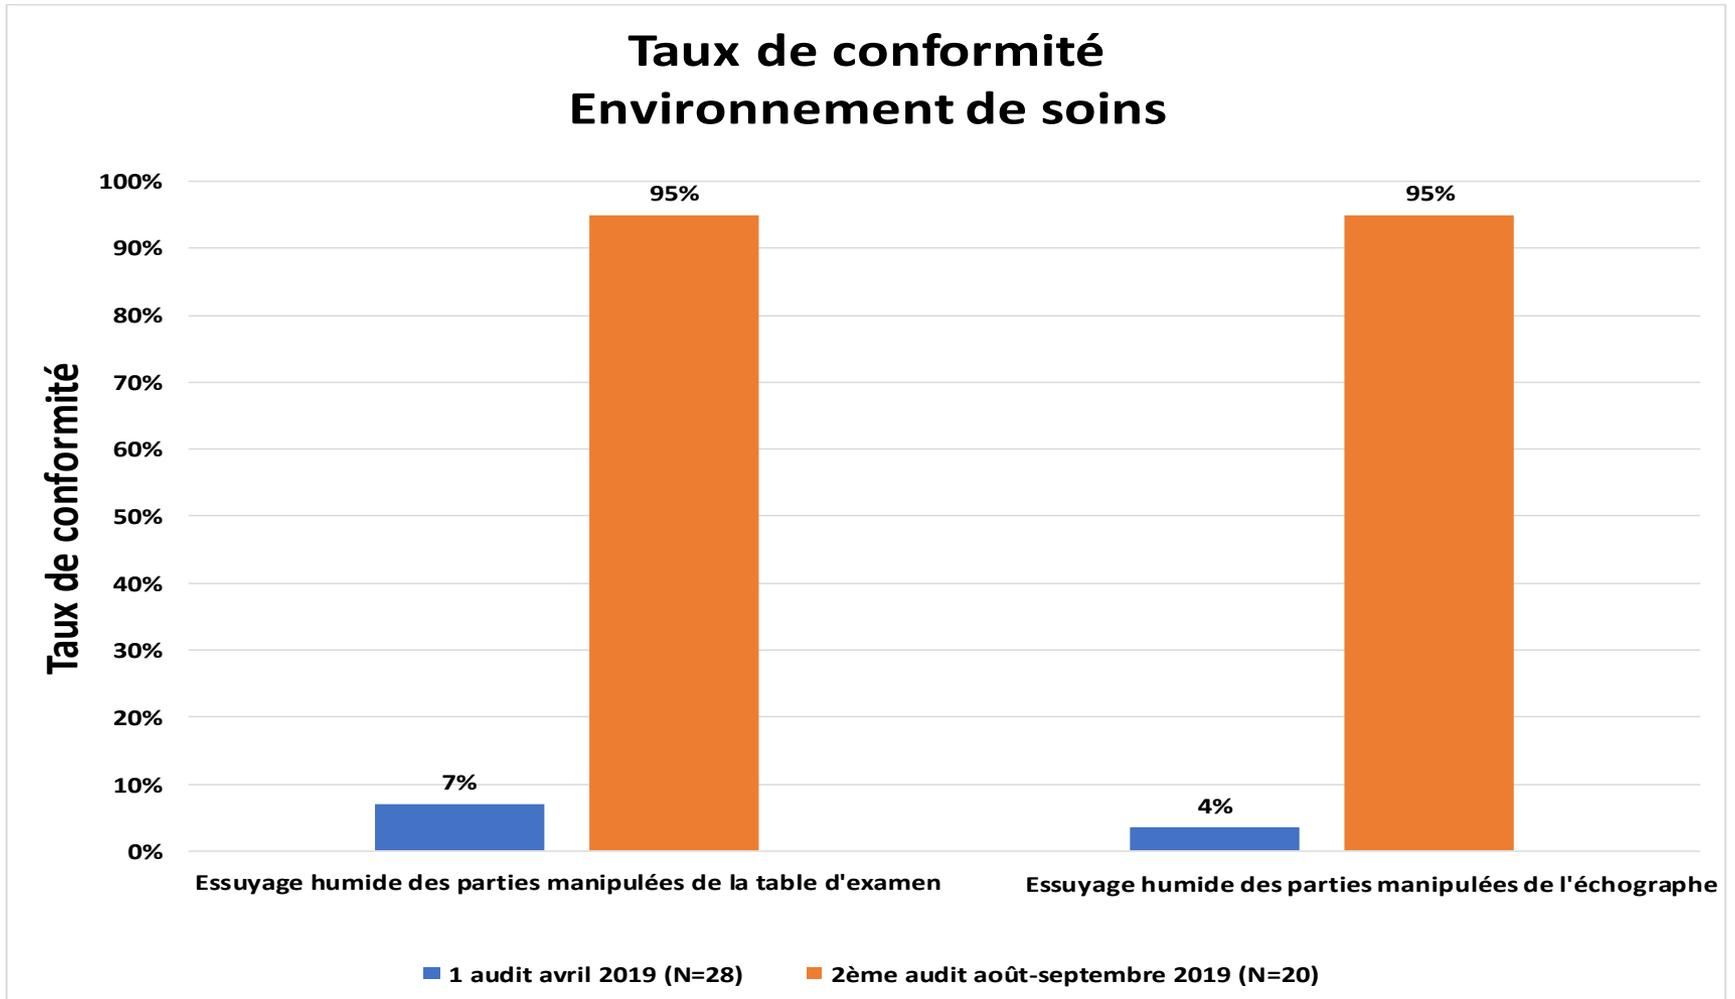

Amélioration des pratiques concernant l'environnement

Résultats


Taux de conformité Modalités de désinfection de la sonde : gaine de protection

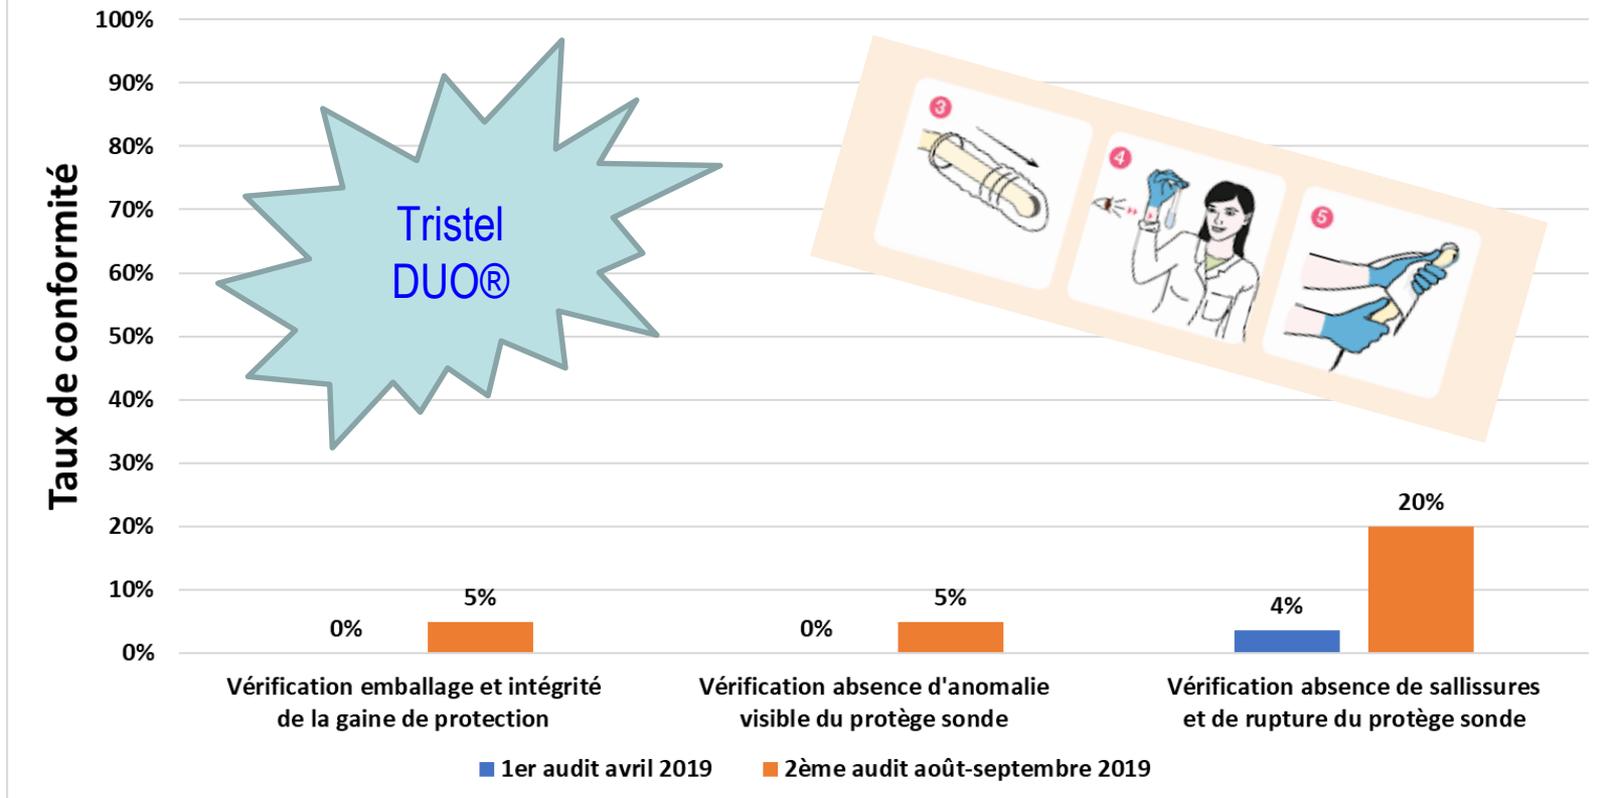

Absence d'amélioration sur la vérification de l'intégrité de la gaine

Discussion

- Force de la formation par simulation
 - Changement profond des pratiques
 - Absence de jugement
 - Répétition du geste
 - Renforcement du lien service de soins / hygiène

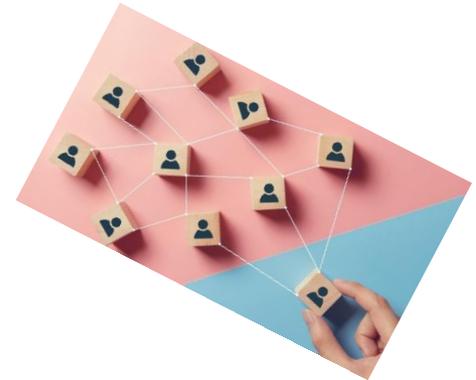


- Limites
 - Chronophage pour l'hygiène
 - Disponibilités ressources humaines et matérielles



Perspectives

- Objectif pérenniser la démarche
 - Diffusion du protocole sur le site de Bel-Air à Thionville et formation du personnel par simulation procédurale
 - Formation des nouveaux internes (contrat de partenariat Pole 1/ SHH) 80 internes depuis 2019
- Informatisation de la traçabilité en cours
- CPIAS : nouvelle enquête nationale

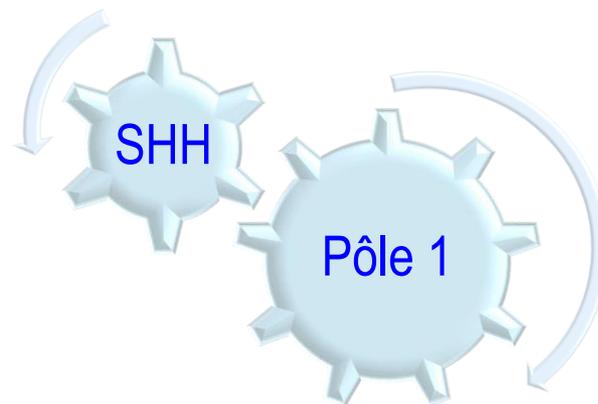

Désinfection des sondes d'échographie endovaginales :
projet d'amélioration des pratiques par formation par simulation



Merci
pour votre attention

